

TP-800PT・Pre



標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモプレミアム

白金温度計のハイエンドモデル誕生

測定精度・再現性・使用感


その全てにおいてプレミアム・クオリティ

トレーサビリティ校正

JCSS校正

温度校正ポイントは9パターンから選べます
(裏面校正ポイント型式表参照)

0.00～199.99℃(～200℃)の
温度範囲で温度測定精度
±0.15℃を実現

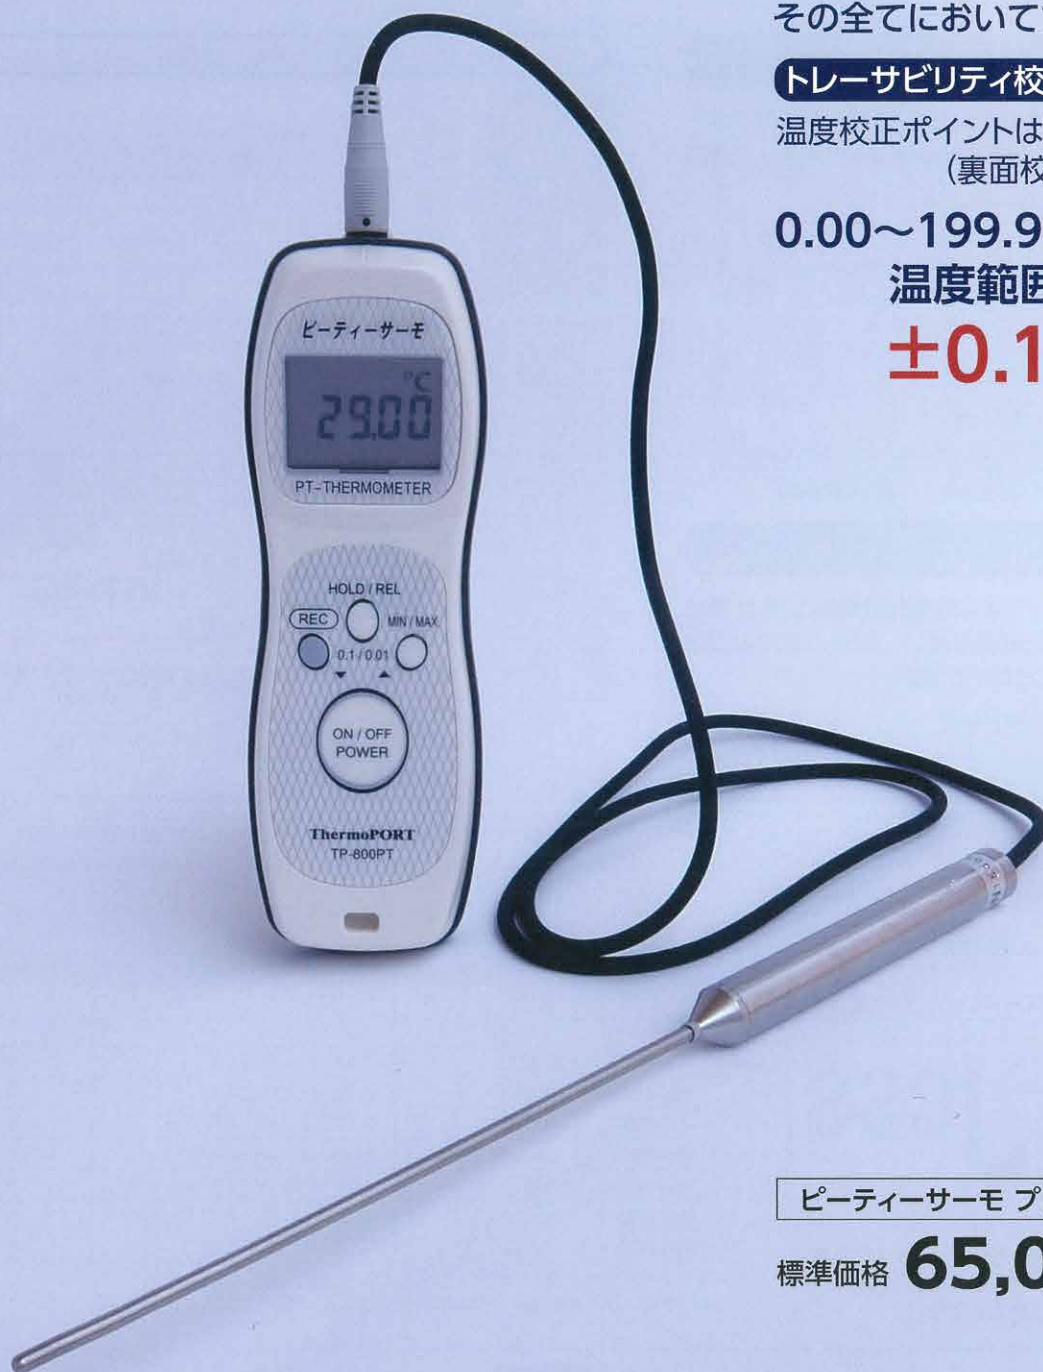

ピーティーサーモ プレミアム TP-800PT・Pre

標準価格 **65,000円** [税抜]+消費税

(センサ PTP-150付属)

(校正費用は含まれていません)

卓越した性能と、安心の品質を――

ThermoPORT 株式会社 **サーモポート**

<http://www.thermoport.co.jp/>

サーモポート

検索

ピーティーサーモ

検索


ISO14000,ISO9001,HACCPなど 各産業界に関連する法律・規格・品質マネジメントシステム対応を支援します

温度管理が重要となる主なマネジメントシステム

- ① ISO 9001：品質マネジメントシステム
- ② ISO 14001：環境マネジメントシステム
- ③ ISO 22000：食品安全マネジメントシステム
- ④ FSSC 22000：食品安全マネジメントシステム
(ISO 22000を追加要求事項で補強した
食品安全マネジメントシステムに関する国際基準)
- ⑤ HACCP：危害分析重要管理点(12手順と7原則)
- ⑥ JFS-C(食品安全)：一般財団法人食品安全マネジメント協会(JFSM)
が開発した日本初の食品安全マネジメントシステムの認証スキーム
(フードチェーン全体での食品安全確保のための取り組み標準化)
- ⑦ IATF 16949(自動車)：自動車産業に特化した品質マネジメント
システムに関する国際規格
- ⑧ ISO 13485(医療機器・体外診断用医薬品)：医療機器産業に特化した品質
マネジメントシステムに関する国際規格
- ⑨ ISO 15189：臨床検査室の品質と能力に関する要求事項を定めたISO規格

トレーサビリティ校正

定期的な校正を実施して、ISO 14000、ISO 9001、HACCPなど
各産業界に関連する法律、規格、品質マネジメントシステムに対応
しましょう。



トレーサビリティ証明書



トレーサビリティ体系図



校正試験成績書

JCSS校正

当社はJCSS認定事業者である「株式会社安藤計器製工所 計量校正研究所(JCSS 0309)」に校正依頼を行い、JCSS 0309の校正
証明書付きで製品を販売することができます。



校正証明書



校正結果

※ピーティーサーモのJCSS校正書類です。



株式会社安藤計器製工所計量校正研究所は、計量法校正事業者登録制度に基づく登録事業者です。JCSS登録事業者は、ISO/IEC17025を基準として登録されています。

製造元

ThermoPORT 株式会社 サーマポート

〒337-0005 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作42-2 TEL.048-680-1881
FAX.048-680-2000 <http://www.thermoport.co.jp/> info@thermoport.co.jp

Made in Japan 国内設計・製造・検査

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ※記載内容および価格は、平成30年9月現在のものです。

ピーティーサーモ・プレミアム仕様

■本体部

製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
型式	TP-800PT・Pre(センサ PTP-150付)
温度表示範囲	0.00~199.99℃(～200.0℃)
表示分解能	0.01℃(at -99.99~199.99℃)
温度測定精度	±0.15℃(本体表示精度含む)
表示サンプリング	約0.5秒
本体機能	最高温度(MAX)メモリ、最低温度(MIN)メモリ、 HOLD(表示値固定)機能、偏差(REL)値表示機能、 REC(データ記録)機能、REC値データ読み出し機能、 分解能切り換え機能、ローバッテリーマーク、 オートパワーオフ機能(30分)
材質	本体：抗菌ABS樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂 パッキン：シリコンゴム
電源	単4型乾電池 2本(マンガンまたはアルカリ) DC1.5V×2本 充電式乾電池 DC1.2V×2本 使用可能
電池寿命	連続使用 約500時間以上(アルカリ乾電池使用時)
寸法	(W)54×(H)172×(D)40mm
質量	約150g(乾電池含む)
付属品	・取扱説明書 1枚 ・単4アルカリ乾電池 2本 ・標準センサ(PTP-150) 1本 ・ネックストラップ 1本 ・本体ビニールカバー 1枚 ・検査成績書(0℃・100℃・200℃) 1枚

※センサ温度測定範囲は-99.99~400.0℃ですが、ピーティーサーモ プレミアムは
温度測定精度保証範囲0.00~199.99℃(～200.0℃)となります。

※ピーティーサーモ プレミアムとして、温度計本体のみ、センサのみの販売はできません。

校正ポイント型式表

型式	名称	校正(温度)ポイント(℃)	校正ポイント数
Pre-800-A	標準校正ポイント	0,100,200℃	3
Pre-800-B	常温用	0,25,50℃	3
Pre-800-C	中温用	0,50,75,100℃	4
Pre-800-D	高温用	0,100,150,180℃	4
Pre-800-E	0-50℃	0,10,20,30,40,50℃	6
Pre-800-F	50-100℃	50,60,70,80,90,100℃	6
Pre-800-G	100-150℃	100,110,120,130,140,150℃	6
Pre-800-H	150-200℃	150,160,170,180,190,200℃	6
Pre-800-J	全域校正タイプ	0,50,100,150,200℃	5

※分解能~199.99℃まで0.01℃(200℃以上は0.1℃)

※ご希望の温度にて校正可能です。お問い合わせください。

■販売店

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>